



ASL8
NP/2013/0021323 del 24/05/2013 ore 1
Mittente P.O. Binaghi
Assegnatario: Patrimonio e Servizi Tecnici
Classifica: 1.4.5 Sottofasc. 14-1 del 2013

P.O. "R. BINAGHI" - CAGLIARI
Tel. 070 609 3083/3082
Servizio di Radiologia
Responsabile : Dott.ssa M. Antonietta Barracciu

Spett.le Responsabile Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici
Ing. Massimo Masia

SEDE

Oggetto : Richiesta dotazioni attrezzature sanitarie

Onde ottemperare ai requisiti di Legge relativi alla sicurezza del paziente in Radiodiagnostica , in particolare in relazione all ' esecuzione di esami con mezzo di contrasto , come da circolare n ° 81 del 09 09 1975 e n° 64 del 28 09 1979 del Ministero della Sanità (" effetti secondari conseguenti all ' uso dei mezzi di contrasto organo - iodati per via iniettiva ") , si richiedono con urgenza le seguenti attrezzature sanitarie :

(A)

N° 2 carrelli d ' emergenza con le seguenti caratteristiche:

Struttura portatile in acciaio ed alluminio ; rivestimenti esterni , cassetti, mensole ed ante di chiusura polimero con trattamento antimicrobico integrato nella mescola , non verniciata e priva di lattice.

Dimensioni ; cm. 77 x cm . 70 x cm. 100/157H

5 cassetti frontali di H diversa con profili colorati di diverso colore (n2 da 75 mm, n1 da 155mm, n1 da 235mm, e n1 da 320) le misure sono indicative

inserto organizzativo regolabile per ogni cassetto da 75,155 e 235 mm


piastra porta defibrillatore girevole a 360°, con dispositivo di bloccaggio ampliabile a piacere per adattarsi a qualsiasi defibrillatore, dotato di cinghia di sicurezza.

Supporto per massaggio cardio-respiratorio, posizionabile a richiesta anteriormente o posteriormente alloggiamento per pompa di aspirazione e supporto per contenitore secreti e tubo di raccordo, vano porta cateteri, porta flebo a 2 ganci regolabile in altezza, cestello porta rifiuti, alloggiamento bombola ossigeno fino a 5 litri, chiusura centralizzata con sigillo di sicurezza numerato monouso (confezione in dotazione almeno 100 pezzi)

ruote antistatiche diam. 125 mm, piroettanti, 2 con freno, possibilmente di 5° di emergenza di emergenza inseribile dall'operatore tramite apposito comando su maniglia di spinta o pedaliera

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA N° 57 DEL 16 GEN 2014

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli
di n° 2 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

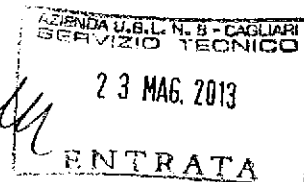

N° 2 Defibrillatori , aventi ognuno le seguenti caratteristiche:

14 SORS

2

1. semiautomatico
2. Idoneo alla defibrillazione per adulti e pediatrica
3. Forma d'onda bifasica esponenziale troncata
4. Indicazioni acustiche di guida dell'utilizzatore
5. Batteria non ricaricabile ad elevata autonomia in stand-by ed in termini di n° di scariche
6. Possibilità di programmazione dell'apparecchiatura in funzione dell'eventuale variazione delle linee guida IRC-ERC (italiane ed europee)
7. Sistema di check automatico di corretto funzionamento dell'apparecchio
8. completo degli accessori necessari al suo pieno funzionamento tra cui:
 1. pacco batterie
 2. 1 coppia di piastre per adulti
 3. 1 coppia di piastre pediatriche (o adattatore a corredo)

Le dotazioni in oggetto sono destinate alla diagnostica TC e alla diagnostica RM , di prossima acquisizione.

In attesa di un Vostro cortese riscontro , porgo Cordiali Saluti

La Responsabile

Cagliari 22 05 2013

Dott.ssa M. Antonietta Barracciu

