

su. "A"

374

26 MAR. 2014

Z490DAABEE


RDO 412196


Presidio Ospedaliero
Marino

Rianimazione,
Medicina Iperbarica


Il presente allegato è com-
posto di n° 2 fogli.

Il Direttore del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

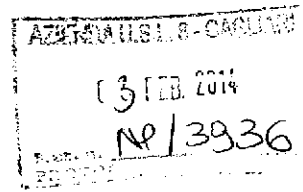

AI  Responsabile Servizio Tecnico
e gestione del patrimonio
ASL Cagliari
Ing. Massimo Masia
Via Piero della Francesca
SELARGIUS

111014

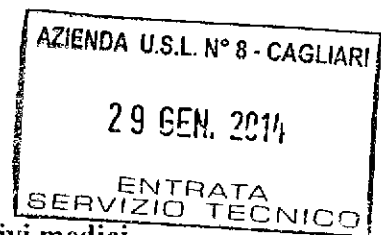

Oggetto: Richiesta fornitura Lavatrice per maschere e per dispositivi medici.

In vista della messa in esercizio della nuova Camera Iperbarica, si richiede la fornitura urgente di un **Termodisinfettore** ad alte prestazioni con essiccatore ad aria calda per il trattamento delle maschere per Ossigeno Terapia Iperbarica e dei piccoli dispositivi medici.

Il **Termodisinfettore** dovrebbe avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- ✗ Comando elettronico programmabile con possibilità di configurare programmi specifici
- ✗ Riconoscimento automatico del carrello
- ✗ Sensore sul braccio irroratore per il monitoraggio delle rotazioni ,
- ✗ Protezione da errori di carico e da formazione di eccessiva schiuma nel sistema di circolazione.
- ✗ Rivestimento esterno in acciaio inossidabile
- ✗ Misure: Misure esterne circa H/L/P [mm]: 1175/900/700,
- ✗ Tecnologia di lavaggio: Sistema ad acqua con sostituzione dell'acqua dopo ogni fase di lavaggio.
- ✗ Gli ugelli devono essere posizionati in modo da impostare le rotazioni del braccio irroratore.
- ✗ Disinfezione termica: minimo 90°C per un tempo minimo di 10 min.

- ✕ Capacità di carico: deve poter lavare contemporaneamente almeno 15 maschere per Ossigeno Terapia Iperbarica
- ✕ blocco elettrico dello sportello con sensori ridondanti per la regolazione ed il controllo della temperatura
- ✕ Dispositivi di sicurezza in conformità a EN ISO 15883
- ✕ Addolcitore dell'acqua
- ✕ Asciugatura mediante essiccatore ad aria calda integrato

Cordialmente

Paolo Castaldi

ASL n° 8 - OSPEDALE MARINO
RIANIMAZIONE
IL RESPONSABILE
Dr. Castaldi Paolo (Matr. 7020)