


1/1001 93/13

Allegato A

403
28 MAR. 2014

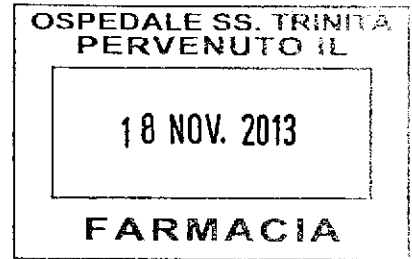

RICHIESTA MATERIALE A UNICO OPERATORE ECONOMICO

SCHEDA PRODOTTO

Il sottoscritto Dott. Stefano Marcia nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero SS. Trinità sotto la propria responsabilità, chiede che venga acquisito il materiale indicato prodotto dall'Operatore Economico BOSTON e commercializzati in Sardegna dall'Operatore Economico MEMIS s.r.l.. Precisa che il prodotto richiesto è l'unica scelta possibile per raggiungere un determinato obiettivo e che, pertanto, non esistono possibilità alternative per ottenere un uguale risultato. Per tale motivo non è stato inserito tra le forniture al cui approvvigionamento si procede mediante gara d'appalto, poiché trattasi di:

- Prodotto di nuova tecnica, recentemente immesso sul mercato
Fornitura di prodotto che, per ragioni di natura tecnica, può essere affidata unicamente all'Operatore Economico su indicato
- Fornitura del prodotto che, per ragioni di tutela di diritti esclusivi, può essere affidata unicamente all'Operatore Economico su indicato
Consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o ampliamento di forniture di uso corrente, poiché il cambiamento di fornitore obbliga ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego comporta incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.
- Altro:

• Descrizione tecnica del prodotto e finalità

Set composto da ago "Speedy bell" semiautomatico a ghigliottina ed ago introduttore con punta Trocar con possibilità di scelta della dimensione del prelievo.

• A cosa serve?

Biopsie Tc ed Eco guidate dei tessuti molli

• Vantaggi e benefici per il paziente

E' dotato di introduttore che consente prelievi multipli con unico posizionamento e minor rischio di complicanze. Si può citoaspirare con l'ago introduttore. La possibilità di scegliere le dimensioni del prelievo riduce il rischio di complicanze.

• Vantaggi e benefici per l'operatore

Consentono di penetrare il tessuto in maniera agevole e poco traumatica. La possibilità di scegliere la dimensione del prelievo amplia il numero di lesioni su cui compiere la biopsia.

• Sostituzione totale o parziale della metodica attuale

Totale in quanto il precedente dispositivo è dotato di unico avanzamento di 25 mm del mandrino durante il prelievo biotipico.

Il presente allegato è com-

posto da n° 4 fogli

di n° _____ pagine.

IL RESP. SERV. ACQUISTI
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

N.B: condizione essenziale per l'accoglimento della presente dichiarazione è la sua compilazione in ogni parte, da tutti i sottoscrittori

-
-
- Popolazione beneficiaria in percentuale rispetto all'attuale
15%

-
- Cosa non si può trattare in assenza de materiale richiesto e cosa comporta

Le lesioni che per sede e dimensioni necessitano di variare la lunghezza del prelievo, riducendo i prelievo chirurgici a cielo aperto.

- Che i prodotti analoghi esistenti nel Presidio non sono idonei per le seguenti motivazioni

Scarsa qualità del prelievo istologico, quando presete, impossibilità di ottenere contestualmente un citoaspirato.

-
- Se trattasi di miglioramento tecnologico quantificare l'incremento di attività

15%

-
- Se trattasi di sostituzione di materiale inadeguato o obsoleto, chiarire che cosa non è più garantibile:

La biopsia percutanea TC-guidata (specie polmone, mediastino, pancreas con prelievi multipli mediante singolo posizionamento)

In riferimento a tutto quanto sopra evidenziato, si è in grado di ottenere il seguente risultato:
Altissima percentuale di successo tecnico-procedurale e di diagnosi istologiche adeguate, con possibilità di eseguire gli approfondimenti diagnostici sul materiale prelevato con l emoderne tecniche immunoistochimiche e di analisi recettoriale.

FABBISOGNO ANNUALE PREVISTO 500 PEZZI CIRCA IN VARIE CONFIGURAZIONI E MISURE SECONDO ESIGENZA

CODICI

SET DA BIOPSIA DOPPIO AVANZAMENTO

- SBDTR1410EC
- SBDTR1415EC
- SBDTR1420EC
- SBDTR1610EC
- SBDTR1615EC
- SBDTR1620EC
- SBDTR1810EC
- SBDTR1815EC
- SBDTR1820EC

AGO INTRODUTTORE PUNTA TROCAR DA 14 E 16 G MISURA 70 MM

U. So 107

STR1607EC

STR1407EC

ASL Cagliari - Ospedale SS. Trinità

U.O.C. RADIOLOGIA

RESPONSABILE

Doct. Marina Marcia

(Matr. 51215)

(firma leggibile)

(se di pertinenza sanitaria)

PARERE DELLA DIREZIONE DI FARMACIA E SANITARIA

*D.M. in uso, lesioni ultime portate infamato
M. 7/6/2012 con sospet di spese esecute, scadut
al 05. 11. 2013*

IL DIRETTORE DI FARMACIA



IL DIRIGENTE SANITARIO



(se di pertinenza amministrativa)

PARERE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

16.12.13 *Szia* *elestere conferme codice*
18.12.13 *conseguite i livelli x conferme codice*

FABBISOGNO ANNUALE PREVISTO 500 PEZZI CIRCA IN VARIE CONFIGURAZIONI E MISURE
SECONDO ESIGENZA

CODICI

MB 19.12.13 *alla c.a. S. Teodoro*

SET DA BIOPSIA DOPPIO AVANZAMENTO

l'infrastruttura conferme
il codice BYS BDR

- BY* SBDTRI410EC
- BY* SBDTRI415EC
- BY* SBDTRI420EC
- BY* SBDTRI610EC
- BY* SBDTRI615EC
- BY* SBDTRI620EC
- BY* SBDTRI810EC
- BY* SBDTRI815EC
- BY* SBDTRI820EC

A.S.L. *M. B.* OSPEDALE *S. Teodoro*
Servizio Farmacia
Piazza *M. Doiores De Nuro* - Matr. 11825

AGO INTRODUTTORE PUNTA TROCAR DA 14 E 16 G MISURA 70 MM
STR1607EC
STR1407EC

U. So 07

ASL Cagliari - Ospedale SS. Trinità

U.O.C. RADIOLOGIA

RESPONSABILE

Dot. Stefania Marica

(Matr. 31213)

(firma leggibile)

(se di pertinenza sanitaria)

PARERE DELLA DIREZIONE DI FARMACIA E SANITARIA

D.H. in uso, lesioni ultime puntate infamabili
M. 7/6/2012 con sospetto di spere esaurito, scatur
el 05. 11. 2013

IL DIRETTORE DI FARMACIA

[Firma]

IL DIRIGENTE SANITARIO

[Firma]

(se di pertinenza amministrativa)

PARERE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

N.B: condizione essenziale per l'accoglimento della presente dichiarazione è la sua compilazione in ogni parte, da tutti i sottoscrittori